




บัญชี รายการครุภัณฑ์

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

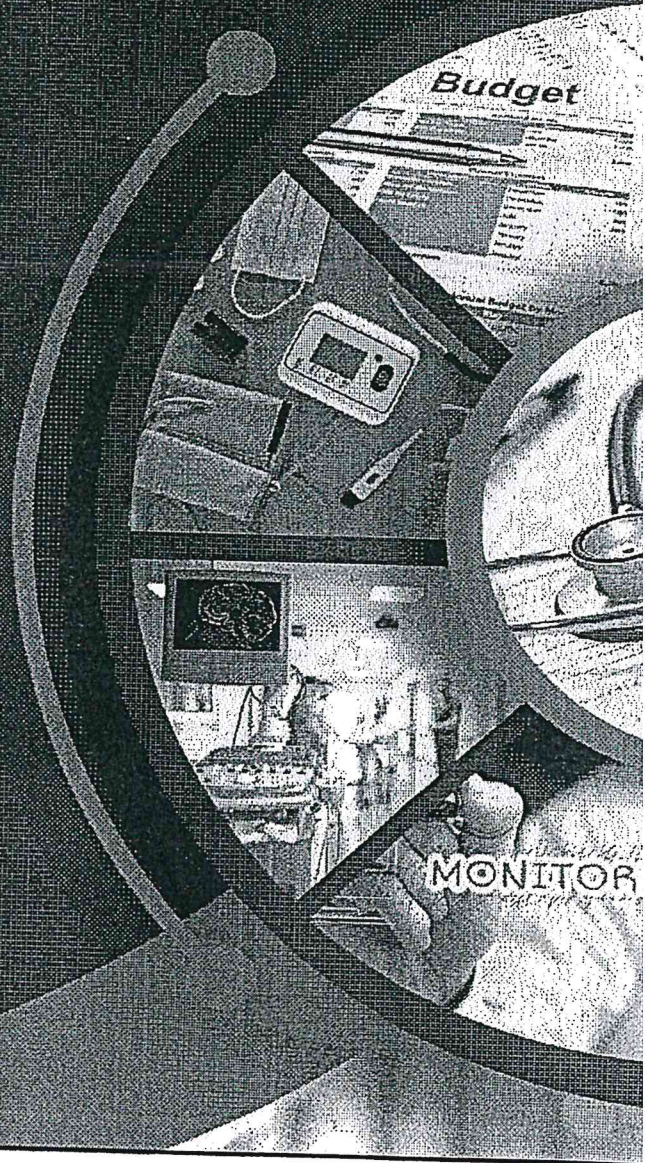

บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับ กันยายน 2566

ประเภทครุภัณฑ์	กลุ่มเครื่องมือ	รหัสครุภัณฑ์	ชื่อรายการ (ภาษาไทย)	ราคา (ต่อหน่วย)	หน่วยนับ	แหล่งอ้างอิง	รอบบัญชี การอ้างอิง
ครุภัณฑ์การแพทย์	กายภาพบำบัด	PT-11	ตู้รังสีไฟฟ้า	120,000	เครื่อง	สป.สธ.	ฉบับ พ.ค. 65
ครุภัณฑ์การแพทย์	กายภาพบำบัด	PT-12	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงไม่ปรับระดับ	160,000	เครื่อง	สป.สธ.	ฉบับ พ.ค. 65
ครุภัณฑ์การแพทย์	กายภาพบำบัด	PT-13	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า	200,000	เครื่อง	สป.สธ.	ฉบับ พ.ค. 65
ครุภัณฑ์การแพทย์	กายภาพบำบัด	PT-14	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัตราชาวด์	250,000	เครื่อง	สป.สธ.	ฉบับ พ.ค. 65
ครุภัณฑ์การแพทย์	กายภาพบำบัด	PT-15	เครื่องกระตุ้นการกัสนด้วยกระแสไฟฟ้า	250,000	เครื่อง	สป.สธ.	ฉบับ พ.ค. 65
ครุภัณฑ์การแพทย์	กายภาพบำบัด	PT-16	เครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่อง	260,000	เครื่อง	สป.สธ.	ฉบับ พ.ค. 65
ครุภัณฑ์การแพทย์	กายภาพบำบัด	PT-17	เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าแบบต่อเนื่อง	300,000	เครื่อง	สป.สธ.	ฉบับ พ.ค. 65
ครุภัณฑ์การแพทย์	กายภาพบำบัด	PT-18	เครื่องบริหารข้อเท้าแบบต่อเนื่อง	300,000	เครื่อง	สป.สธ.	ฉบับ พ.ค. 65
ครุภัณฑ์การแพทย์ หน้าร้าน 6,000 บาท	กายภาพบำบัด	PT-19	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้	350,000	เครื่อง	สป.สธ.	ฉบับ พ.ค. 65
ครุภัณฑ์การแพทย์	กายภาพบำบัด	PT-20	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น	370,000	เครื่อง	สป.สธ.	ฉบับ พ.ค. 65

ลำดับที่ 137

กลุ่มเครื่องมือแพทย์ (ตามมาตรฐานสากล)
กลุ่มเครื่องมือแพทย์จากบัญชีรายการครุภัณฑ์ สป.สธ.

Therapeutic Equipment
กายภาพบำบัด

รายการ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับ
เครื่องมือแพทย์: ได้

รหัสครุภัณฑ์ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ สป.สธ. : PT-19


รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย : -

รายการ เครื่องมือแพทย์
ตามมาตรฐาน
สากล : Traction Units with Tables,
Examination/Treatment, Adjustable,
Orthopedic, Traction

รหัสเครื่องตามระบบ UMDNS : 14105

หน้าที่การทำงาน :

เครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ ใช้ในการบำบัดรักษาโรคและบรรเทา
อาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองกระดูกสันหลัง ข้อต่อหลัง
กล้ามเนื้อหลัง และกล้ามเนื้อต้นคอ หมอนรองกระดูกและกระดูกต้นคอ
พร้อมเตียงไฟฟ้าแบบปรับระดับได้

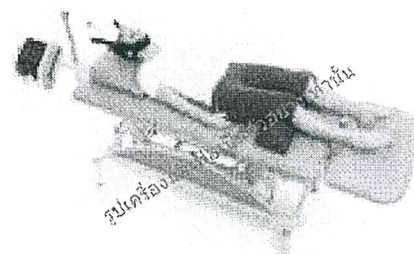

อายุการใช้งานที่คาดหวัง (ปี)

7

ความเสี่ยงในการใช้งาน
Medium-กลาง

ช่วงราคาต่อหน่วย

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)

เครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน

ราคาจากผู้ขายในประเทศไทย(บาท)
375,000-385,000

ราคามัณชีรายการครุภัณฑ์ สป.สธ. ปี 2565 (บาท)
350,000

หมายเหตุ

คุณลักษณะเฉพาะอย่างย่อ :

1. เป็นเครื่องที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ มี Self test
ขณะเปิดเครื่องทุกครั้ง
2. มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบสัมผัสได้ หรือเป็นหน้าปัดแผงควบคุมการ
ทำงานที่แสดงตัวเลขและสัญญาณไฟ
3. สามารถปรับตั้งแรงดึงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม (900 นิวตัน)
และสามารถตั้งแรงดึงต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม (50 นิวตัน) หรือ
เลือกตั้งจากเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวได้
4. ความละเอียดในการปรับแรงดึง อย่างน้อยขั้นละ 0.1 กิโลกรัม สามารถ
เลือกแรงดึงแสดงในหน่วยต่างๆ ได้ เช่น นิวตัน ปอนด์ กิโลกรัม และ
สามารถเลือกตั้งความเร็วในการดึงได้
5. มีระบบตัดการทำงานของเครื่องพร้อมทั้งมีสัญญาณเตือนเมื่อหมดเวลา
6. สามารถตั้งเวลาหน่วงการดึงและคลายได้แยกจากกันไม่น้อยกว่าช่วง
0-99 วินาที
7. มีระบบแจ้งเตือนเมื่อแรงดึงมากกว่า 20 กิโลกรัม (200 นิวตัน) และมี
สวิตช์หยุดการทำงานสำหรับผู้ช่วยแบบใช้สายหรือดีกว่ากรณีฉุกเฉิน
9. มีโปรแกรมการรักษาแนะนำไม่น้อยกว่า 4 แบบ และสามารถบันทึก
โปรแกรมเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 50 โปรแกรม
10. มีเตียงสำหรับดึงคอ-ดึงหลัง ลักษณะพื้นเตียงและเบาะแยกเป็นสอง
ท่อนอย่างน้อย สามารถปรับระดับและควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า
ผ่านรีโมทคอนโทรล

รายการอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน

1. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ 1 เครื่อง
2. เตียงดึงคอ-ดึงหลังแบบปรับระดับได้ 1 เตียง
3. แก้อัศจรรย์ขา 1 ชุด
4. รีโมทคอนโทรลสำหรับเตียง 1 ชุด
5. สวิตช์ฉุกเฉินหยุดการทำงาน 1 ชุด
6. น็อตยึดแท่นวางเครื่อง 4 ชิ้น
7. เชือกพร้อมตะขอต่อจากเครื่อง 1 ชุด
8. ชุดดึงหลัง (อกและเอว) 1 ชุด
9. ชุดดึงคอพร้อมเหล็กแขวน 1 ชุด

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

ราคาอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม(บาท)

รายการ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับ
เครื่องมือแพทย์: ได้


รหัสครุภัณฑ์ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ สป.สธ. : PT-19
รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย : -

รายการ เครื่องมือแพทย์ Traction Units with Tables,
ตามมาตรฐาน Examination/Treatment, Adjustable,
สากล : Orthopedic, Traction

รหัสเครื่องตามระบบ UMDNS : 14105

หน้าที่การทำงาน :

เครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ ใช้ในการบำบัดรักษาโรคและบรรเทาอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองกระดูกสันหลัง ข้อต่อหลัง กล้ามเนื้อหลัง และกล้ามเนื้อต้นคอ หมอนรองกระดูกและกระดูกต้นคอพร้อมเตียงไฟฟ้าแบบปรับระดับได้

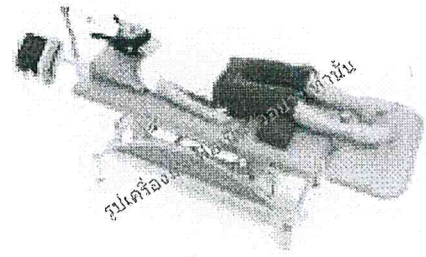

อายุการใช้งานที่คาดหวัง (ปี)

7

ความเสี่ยงในการใช้งาน

Medium-กลาง

ช่วงราคาต่อหน่วย

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)

เครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน

ราคาจากผู้ขายในประเทศไทย(บาท)

375,000-385,000

ราคามัณชีรายการครุภัณฑ์ สป.สธ. ปี 2565 (บาท)
350,000

หมายเหตุ

-

คุณลักษณะเฉพาะอย่างย่อ :

1. เป็นเครื่องที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ มี Self test ขณะเปิดเครื่องทุกครั้ง
2. มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบสัมผัสได้ หรือเป็นหน้าปัดแผงควบคุมการทำงานที่แสดงตัวเลขและสัญญาณไฟ
3. สามารถปรับตั้งแรงดึงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม (900 นิวตัน) และสามารถตั้งแรงดึงต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม (50 นิวตัน) หรือเลือกตั้งจากเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวได้
4. ความละเอียดในการปรับแรงดึง อย่างน้อยขั้นละ 0.1 กิโลกรัม สามารถเลือกแรงดึงแสดงในหน่วยต่างๆ ได้ เช่น นิวตัน ปอนด์ กิโลกรัม และสามารถเลือกตั้งความเร็วในการดึงได้
5. มีระบบตัดการทำงานของเครื่องพร้อมทั้งมีสัญญาณเตือนเมื่อหมดเวลา
6. สามารถตั้งเวลาหน่วงการดึงและคลายได้แยกจากกันไม่น้อยกว่าช่วง 0-99 วินาที
7. มีระบบแจ้งเตือนเมื่อแรงดึงมากกว่า 20 กิโลกรัม (200 นิวตัน) และมีสวิตช์หยุดการทำงานสำหรับผู้ช่วยแบบใช้สายหรือดีกว่ากรณีฉุกเฉิน
9. มีโปรแกรมการรักษาแนะนำไม่น้อยกว่า 4 แบบ และสามารถบันทึกโปรแกรมเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 50 โปรแกรม
10. มีเตียงสำหรับดึงคอ-ดึงหลัง ลักษณะพื้นเตียงและเบาะแยกเป็นสองท่อนอย่างน้อย สามารถปรับระดับและความสูงการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าผ่านรีโมทคอนโทรล

รายการอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน

1. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ 1 เครื่อง
2. เตียงดึงคอ-ดึงหลังแบบปรับระดับได้ 1 เตียง
3. เก้าอี้รองขา 1 ชุด
4. รีโมทคอนโทรลสำหรับเตียง 1 ชุด
5. สวิตช์ฉุกเฉินหยุดการทำงาน 1 ชุด
6. น็อตยึดแท่นวางเครื่อง 4 ชิ้น
7. เชือกพร้อมตะขอต่อจากเครื่อง 1 ชุด
8. ชุดดึงหลัง (อกและเอว) 1 ชุด
9. ชุดดึงคอพร้อมเหล็กแขวน 1 ชุด

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

-

ราคาอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม(บาท)

-