

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องจี้ปิดและตัดเส้นเลือด กรรไกรโค้ง 36 cm. จำนวน 120 EA
(เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) สำหรับปีงบประมาณ 2569

1. ความต้องการ

รายการ อุปกรณ์เครื่องจี้ปิดและตัดเส้นเลือด กรรไกรโค้ง 36 cm. จำนวน 120 EA (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) สำหรับปีงบประมาณ 2569

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์เครื่องจี้ปิดและตัดเส้นเลือด สามารถใช้เลาะ (DISSECTION) , จับเนื้อเยื่อ (GRASPING) และสามารถจี้ตัดเส้นเลือดได้จนถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. หัวจี้ตัดมีให้เลือกใช้กับการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery)

3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

3.2 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4. คุณสมบัติเฉพาะ

- 4.1 ใบมีดด้านที่ใช้จี้ตัดมีลักษณะโค้ง ด้านบนหุ้ม มีความคมด้านล่าง การใช้งานคล้ายกรรไกร
- 4.2 ใบมีดด้านที่ใช้จี้ตัดเคลือบสารป้องกันการไหม้ติดของเนื้อเยื่อ (Non-Sticky Coated)
- 4.3 มีระบบการปรับลดพลังงานอัตโนมัติ (Adaptive Tissue Technology) เมื่อเนื้อเยื่อถูกจี้จนเชื่อมปิดและถูกตัดแล้ว ตัวเครื่องจะส่งเสียงเตือนบอกเซนเซอร์ที่ตัวด้ามจะส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่องให้ปรับลดพลังงานลง ทำให้ช่วยลดอุณหภูมิที่ปากจับ ลดการเกิดควัน ลดเนื้อเยื่อไหม้ที่ติดที่ปากจับและสามารถตัดเนื้อเยื่อได้เร็วขึ้น
- 4.4 สามารถกดปุ่มควบคุมการทำงานของหัวจี้ตัดได้ทั้งมือ (Hand Activate) และเท้า (Footswitch)
- 4.5 ก้านของหัวจี้หมุนได้ 360 องศา จะสะดวกในการปรับมุมและตำแหน่งการจับในขณะที่ผ่าตัด
- 4.6 ก้านของหัวจี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. และสามารถใส่ผ่าน trocar ขนาด 5 มม. ขึ้นไป
- 4.7 หัวจี้ตัดด้ามยาว 36 ซม. ใช้กับการจี้และตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery)

ลงชื่อประธานกรรมการ
(รศ. นพ.จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์)

ลงชื่อกรรมการ
(นางอรอุรา สารีพร)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาววนารัตน์ ชินพันธ์)

5. เงื่อนไขการเสนอราคา

5.1 คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก่อนการจัดซื้อและต้องอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

5.2 ต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอ จำนวน 1 EA นับถัดจากวันที่ได้ยื่นเสนอราคา

5.3 มีหนังสือรับรองผลการใช้งานที่ผ่านการประเมินซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีขึ้นไป จากหน่วยผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยต้องยื่นเอกสารขณะเสนอราคาในระบบ

5.4 กำหนดส่งมอบ 365 วัน

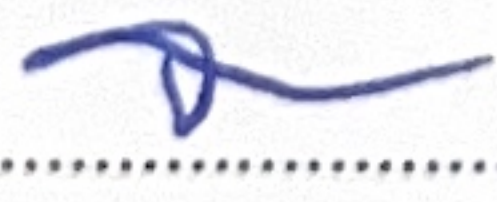
5.4.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

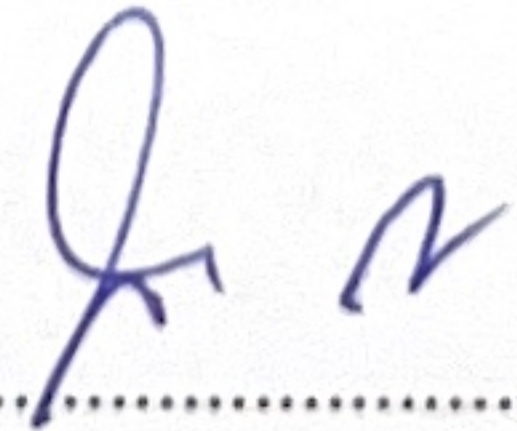
5.4.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ผู้ซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อนระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด


5.4.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ขายไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของนั้นล้นสต็อก ผู้ซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบางงวด โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

6. เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก คือ เกณฑ์ราคา

7. วิธีจัดซื้อ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(รศ. นพ.จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางอรอุรา สารีพร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววนารัตน์ ชินพันธ์)